


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

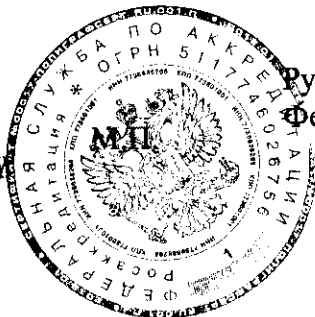

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от « ___ » _____ 20 ___ г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике
Алтай» (ФБУ «Алтайский ЦСМ»)

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется) индивидуального предпринимателя

Горно-Алтайский филиал ФБУ «Алтайский ЦСМ»

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Объездная, д.3


адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности

Проверка средств измерений

АТ

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения механических величин				
1.	Весы электронные (с регистрацией массы и цены, настольные, настольные платформенные, медицинские)	(0,005–600) кг	КТ средний КТ обычный	

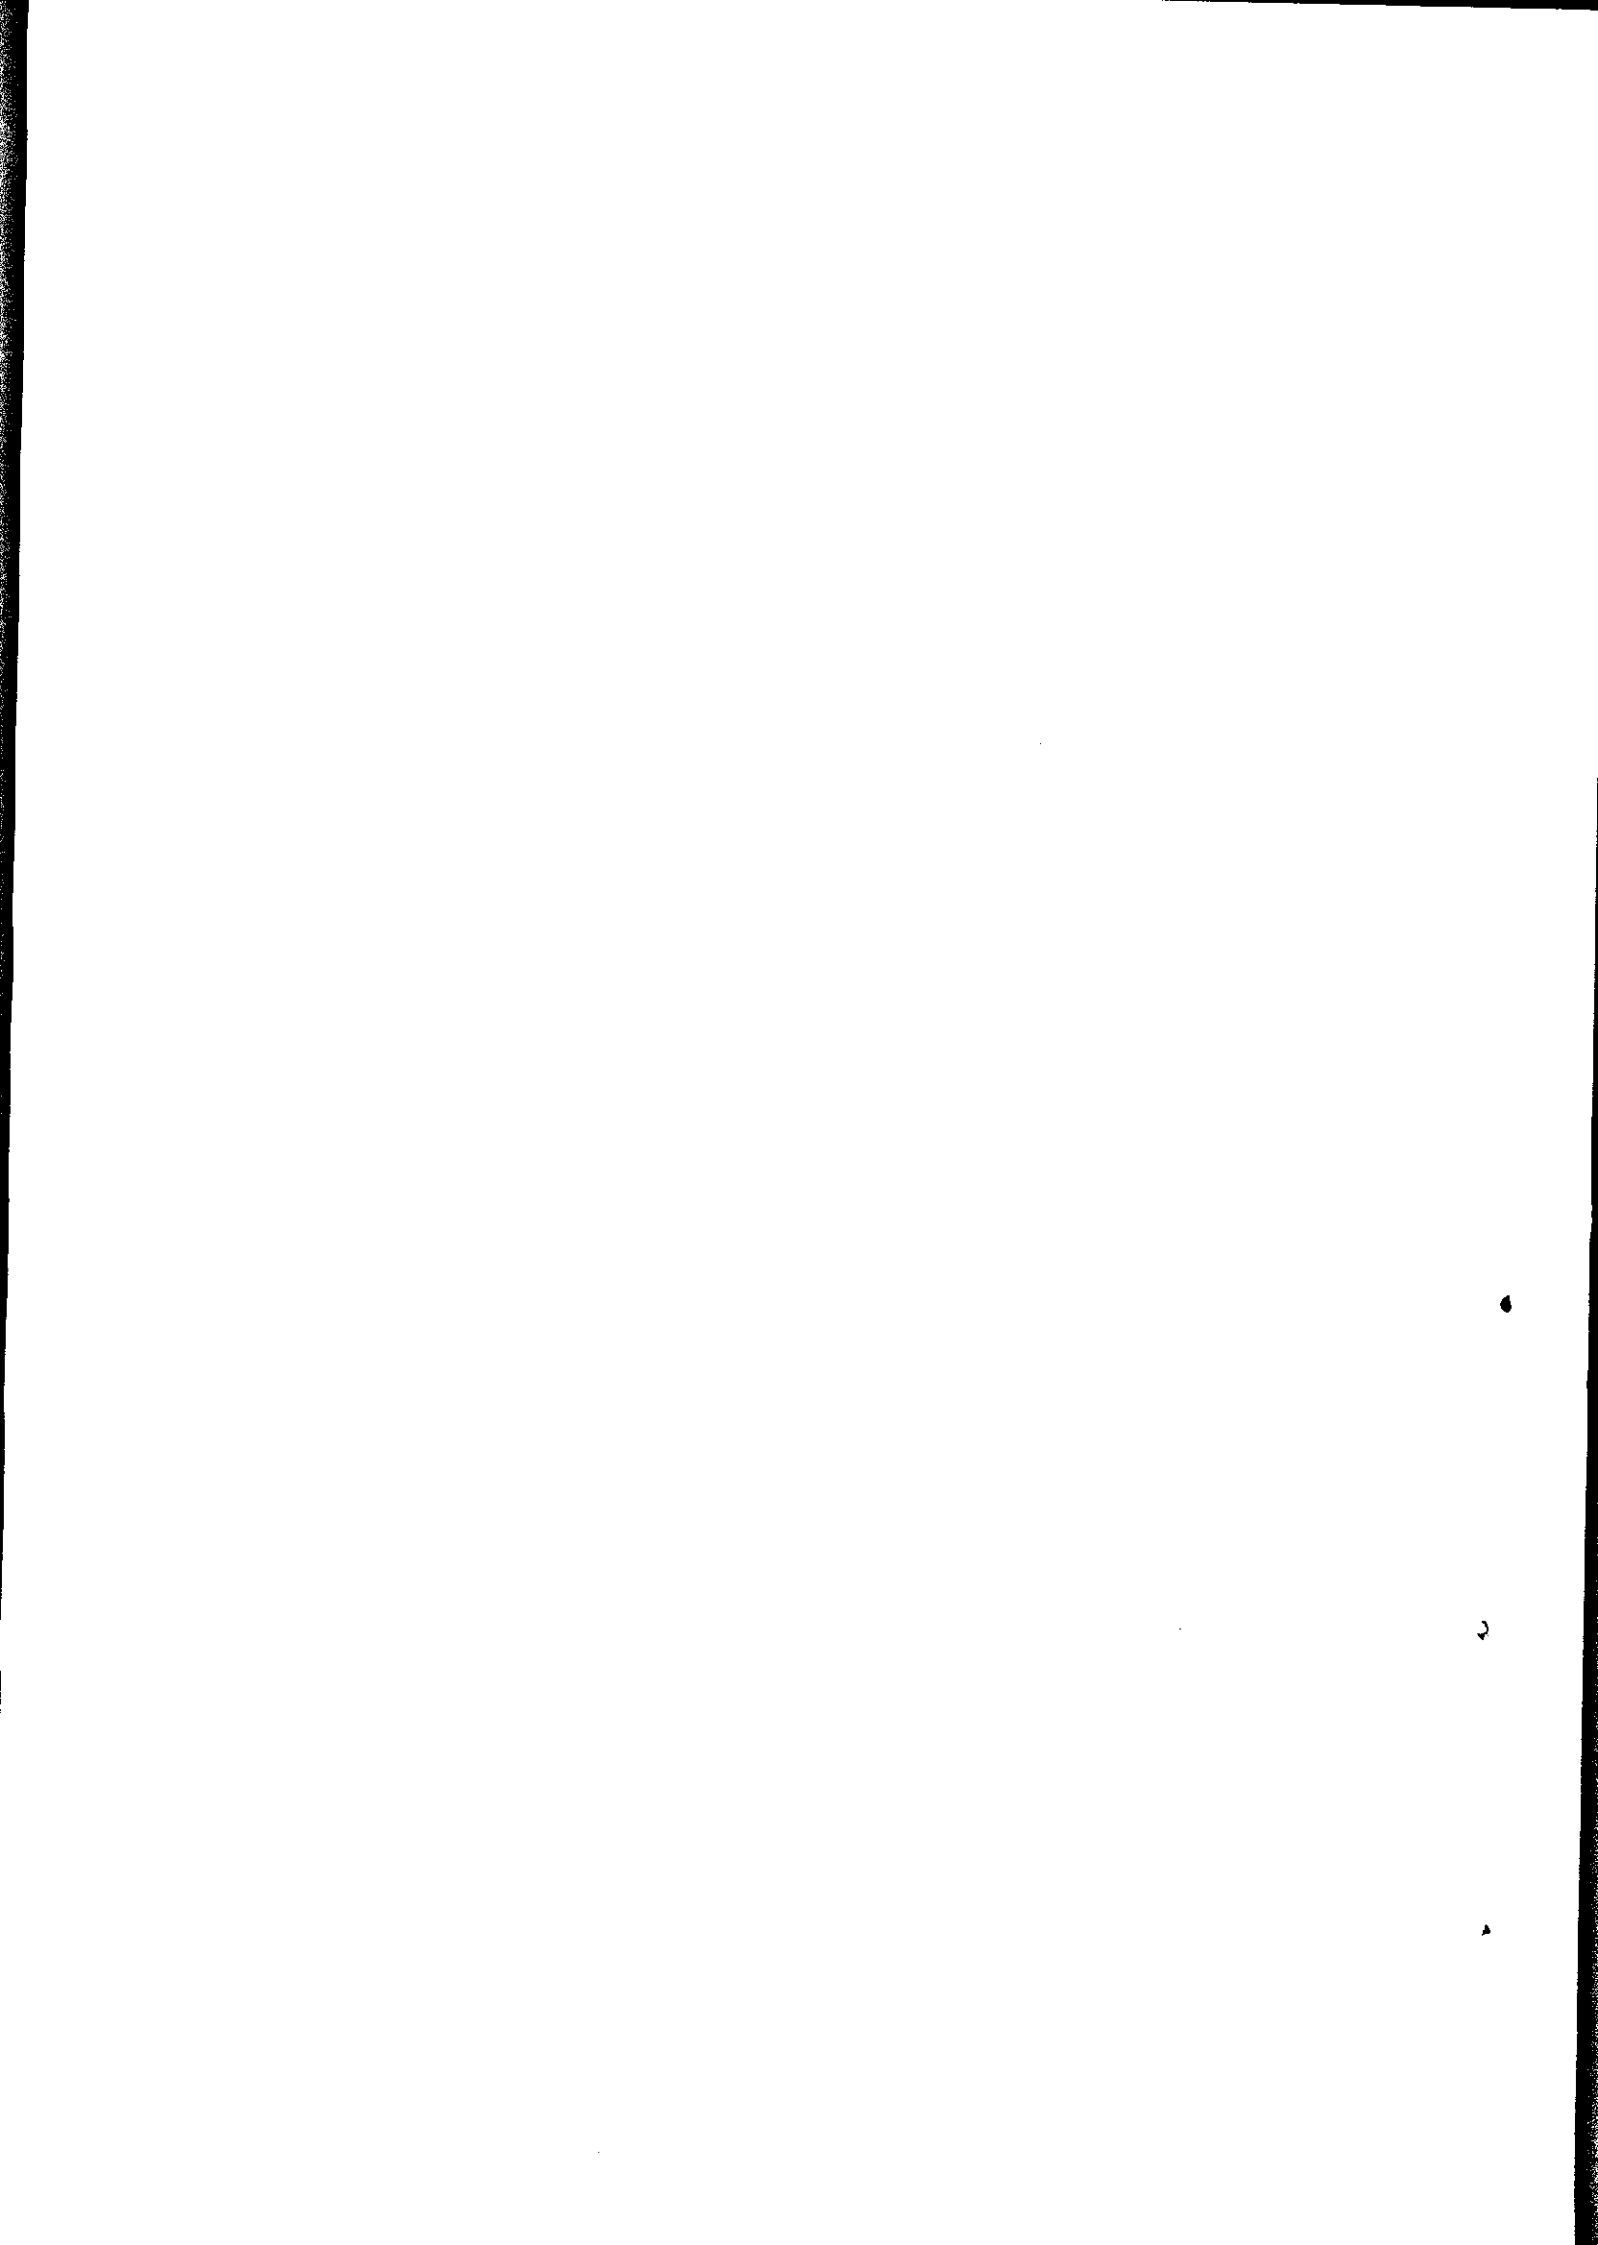

1	2	3	4	5
2.	Весы рычажные (настольные гирные, циферблатные, почтовые, передвижные платформенные, медицинские)	(0,005–600) кг	КТ средний КТ обычный	
3.	Дозаторы весовые дискретного действия	(20–600) кг	КТ (0,1–2,5)	



И.о. директора ФБУ «Алтайский ЦСМ»

Е.В.Романов

Эксперт по аккредитации

Технические эксперты

А.Р. Галяутдинова

А.Д. Федосюк

А.К. Баязитов



И.о. заместителя начальника УМВД РБ
А.А. Романова

А.М. Санатуллина

Торф

П.С. Торфяков